


2214066 DOSYA NO.LU GEZİCİ RÖNTGEN ARACI İHALESİNE AİT
ZEYİLNAME

TEKNİK ŞARTNAME ESKİ ve YENİ MADDELERİ:

ESKİ MADDE 2.2.2- Kasanın içi; Röntgen Odası, Muayene Odası ve Giriş / Danışma alanı olarak 3 bölme olacaktır. Kasanın dıştan dışa uzunluğu en az 430 cm (+/- 10 cm), genişliği en az 220cm (+/- 10 cm), yüksekliği en az 205cm (+/- 10 cm) olacaktır. Aracın ölçülerinin belirtildiği resim aşağıdadır.

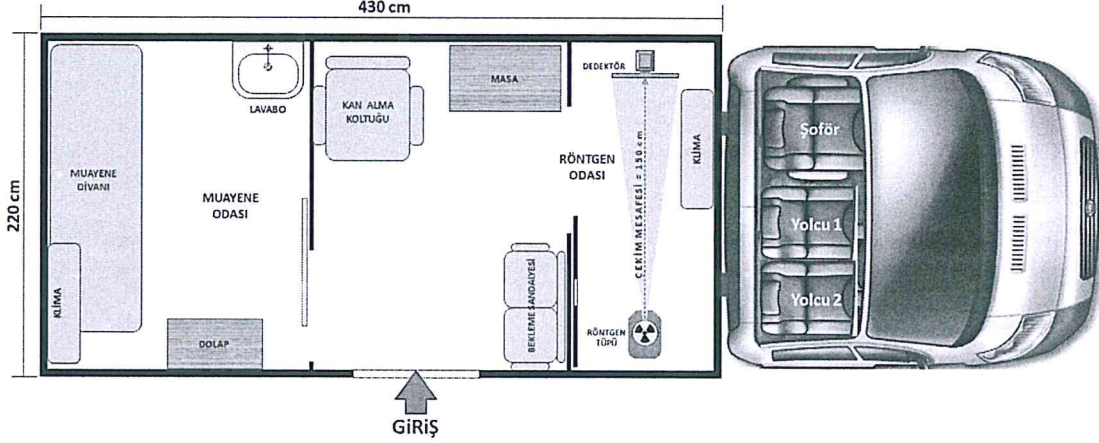

YENİ MADDE 2.2.2- Röntgen Odası, ayrı bir bölme olarak dizayn edilecektir. Diğer ekipman ve donanımlar ayrı bir bölmede uygun şekilde konumlandırılacaktır. Hasta kabini iç ölçüleri en az 400 cm (+/- 10 cm), genişliği en az 190cm (+/- 10 cm), yüksekliği en az 200 cm (+/- 10 cm) olacaktır.

TEKNİK ŞARTNAMEDE İPTAL EDİLEN MADDE:

6.1.5-Röntgen aracı dönüşümünü yapan firma, gezici röntgen aracına dönüştürülen aracın üreticisi tarafından onaylı üstyapıcısı olmalıdır, araç üreticisi tarafından verilen onaylı üstyapıcılık belgesi teklif ile birlikte sunulacaktır.